

CÂMARA GERMINADORA COM FOTOPERÍODO E ALTERNÂNCIA DE TEMPERATURA

CÂMARA GERMINADORA COM FOTOPERÍODO E ALTERNÂNCIA DE TEMPERATURA

MANUAL DO USUÁRIO

- Isolamento térmico em poliuretano expandido em todas as paredes e portas;
- Pouca perda de temperatura para o meio externo;
- Iluminação automática ao abrir a porta;
- Câmara interna revestida com poliimero, pré-moldado, anticorrosão;
- Prateleiras reguláveis e removíveis em aço carbono SAE 1020;
- Chapa externa de aço carbono SAE 1020;
- Pintura eletroestática epóxi lisa com tratamento anticorrosivo;
- Pés niveladores;
- Porta tipo cega com vedação magnética;
- Reservatório interno de água para umidade relativa por evaporação natural.

// FOTOPERÍODO:

- Lâmpadas LED;
- Controlador digital.

// OPCIONAIS:

- Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura;
- Certificado de calibração RBC/INMETRO do equipamento;
- Prateleiras em aço inox;
- Controle de umidade para modelo 342L.

// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TEMPERATURA DE TRABALHO	-10°C até 60°C (outras sob consulta)
PAINEL	Policarbonato com indicador de funções luminoso
CONTROLADOR DE ALTERNÂNCIA DE TEMPERATURA	32 programas com 64 segmentos, total de 2048 segmentos
CONTROLE DE TEMPERATURA	Digital microprocessado com PID e autotuning
DISPLAY	LCD
TIMER	Programável de 00:01 à 99:59 min
PRECISÃO DO SISTEMA	Precisão do controlador +/-0,5°C
HOMOGENEIDADE TÉRMICA	+/-0,3°C
RESOLUÇÃO	0,1°C para indicação da temperatura de processo
CHAVE LIGA/DESLIGA	Com indicador luminoso
SENSOR DE TEMPERATURA	PT 100
SISTEMA DE FOTOPERÍODO	Simulação dia e noite
LUMINAÇÃO	4 lâmpadas LED - 3800 Lux - 10W cada
PROGRAMAÇÃO	Mínimo 1 em 1 minuto com no máximo 8 programas
SAÍDA	4 a 20 mA para registro e monitoramento via software
RESISTÊNCIA	Tubular de aço inox de fácil substituição
CABO DE ALIMENTAÇÃO	Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136
TERMOSTATO	Segurança contra elevação de temperatura e desligamento automático do sistema de refrigeração
VENTILAÇÃO	Sistema silencioso com circulação forçada de ar quente e frio, no sentido vertical, para homogeneidade no interior da câmara
COMPRESSOR HERMÉTICO	Com potência de 1/8 de Hp livre de CFC
ALIMENTAÇÃO	110V ou 220V - definir

// INFORMAÇÕES DO MODELO

MODELO	CAPACIDADE	VOLUME ÚTIL	MEDIDAS INTERNAS AXLC	VOLTAGEM	POTÊNCIA
SSGFa 120L	120 litros	109 litros	54x48,2x42,2 cm	110V ou 220V	200 watts
SSGFa 342L	342 litros	323 litros	134x52,5x46 cm	110V ou 220V	400 watts

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuidades sem aviso prévio.

TERMO DE GARANTIA

Este aparelho é garantido ao primeiro comprador contra defeitos de fabricação ou de material, no prazo de doze meses, a contar "pro-rata-die". Não estarão cobertas por esta garantia as peças fabricadas por terceiros e as peças que sofrem desgaste natural pelo uso, tais como molas, peças de plástico ou nylon, componentes elétricos e eletrônicos, etc.

ESTA GARANTIA PERDERÁ TODA A SUA VALIDADE CASO SEJAM CONSTATADAS QUAISQUER DAS SEGUINTES SITUAÇÕES:

- O equipamento tenha sofrido dano causado por quedas, fenômenos naturais, instalação elétrica inadequada e/ou uso indevido;
- O equipamento tenha recebido manutenção por pessoa não autorizada pela fábrica e/ou peças não originais;
- Imperícia, imprudência e/ou negligência no seu manuseio e operação;
- Não seja apresentado o número de série acompanhado da referida Nota Fiscal de Compra. Esta garantia aplica-se apenas e tão somente às peças de reposição, reparos e regulagens;
- Correrão por conta e risco do comprador todas as despesas decorrentes de: Fretes, carretos, acessórios para remessas e devolução de conserto.

Fotoperíodo – Modos de Operação:

MODOS DE OPERAÇÃO: ON/AUTO/OFF, selecionados através da tecla MANUAL.

Pressionar a tecla MANUAL: um traço no visor se movimenta sobre as palavras ON/AUTO/OFF:

MODO ON: com o traço no visor em ON o TIMER liga a saída permanentemente.

MODO OFF: com o traço no visor em OFF o TIMER desliga a saída permanentemente.

MODO AUTO: Com o traço no visor em AUTO o TIMER baseia-se nos programas para ligar ou desligar a saída. Sem alimentação elétrica, o Timer desliga a saída permanentemente.

ATUALIZANDO DIA/HORA/MINUTO

Manter pressionada a tecla CLOCK, em seguida pressionar:

DAY: para atualizar o dia da semana indicado;

HOURL: para atualizar a hora indicada;

MIN: para atualizar os minutos indicados;

NOTA 1: Os termos MO, TU, WE, TH, FR, SA E SU, correspondem aos dias da

semana na língua inglesa: MO= Segunda, TU= Terça, WE= Quarta, TH= Quinta, FR= Sexta,

SA= Sábado, SU= Domingo

CICLOS DE ON/OFF

Pressionar a tecla TIMER para acessar e determinar os programas ON/OFF.

O número do programa sob ajuste é mostrado à esquerda do visor. Figura 04. O primeiro ajuste refere-se ao programa 1, e determina o momento de LIGAR (ON) a saída. A mensagem ON é mostrada sobre o número do programa.

Pressionar DAY para determinar os dias em que a saída deve ser ligada. A indicação dos dias da semana é alterada a cada pressionar da tecla DAY:

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su (todos os dias da semana)

Mo (um dia qualquer da semana)

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

Sa, Su(fim de semana)

Mo, Tu, We, Th, Fr;

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa (dias úteis mais Sábado);

Mo, We, Fr (Segunda, Quarta, Sexta);

Tu, Th, Sa (Terça e Quinta, Sábado);

Mo, Tu, We (Segunda, Terça e Quarta);

Th, Fr, Sa (Quinta, Sexta e Sábado);

Pressionar a tecla HOUR para determinar a hora dos dias escolhidos, quando a saída será ligada.

Pressionar a tecla MIN para determinar os minutos.

Pressionar a tecla TIMER novamente para determinar o momento de DESLIGAR (OFF) a saída

no programa 1. OFF sobre o número do programa. A programação de dia, hora e minuto é realizada de forma idêntica a realizada na programação de LIGAR (ON):

Pressionar DAY para determinar os dias em que a saída é desligada.

Pressionar HOUR para determinar a hora de desligar a saída.

Pressionar MIN para determinar os minutos.

Pressionar novamente a tecla TIMER e o número do programa mostrado passa para 2,

indicando que os ajuste seguintes referem-se ao programa 2. Configurar o programa 2

conforme as instruções acima. Após, acessar e determinar os demais programas num total

de oito. Estes programas serão utilizados pelo TIMER quando este estiver selecionado para



o modo de operação AUTO (automático). No horário programado em ON a saída é ligada.

No horário programado em OFF a saída é desligada. No caso de programas sobrepostos, a

saída tem comportamento semelhante ao do exemplo mostrado na Figura 01. Quando está

ligada, atingido um horário onde algum programa determina desligar, a saída desliga.

Atingido um horário onde algum programa determina ligar, permanece ligada.

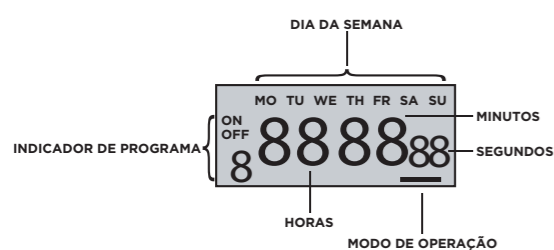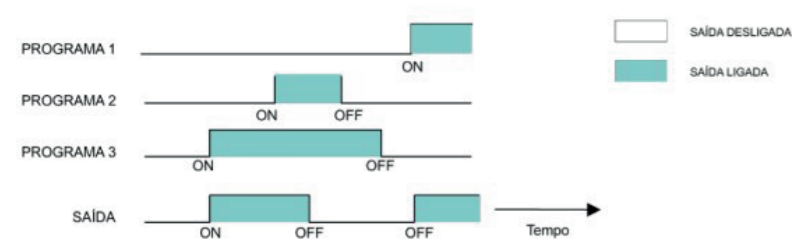

// OPERAÇÃO


DISPLAY	NOME	DESCRIÇÃO	VALORES VÁLIDOS
	Programa Atual	Indica o programa em andamento ou seleciona um programa a ser executado. Disponível se habilitado no parâmetro Prg.Oper no bloco de configuração.	De 01 até 32
	Segmento Atual	Indica o segmento em andamento ou seleciona um novo segmento a ser executado. Disponível se habilitado no parâmetro Prg.Oper no bloco de configuração. Obs: Para mudar de segmento é necessário desligar o programa em andamento (Sit.Prog = Deslig.) selecionar o segmento desejado e religar (Sit.Prog = Ligado).	De 01 até 63
	Tempo Restante do Segmento Atual	Indica o tempo restante do segmento em execução ou ajusta o tempo a ser executado do segmento acima selecionado. Disponível se habilitado no parâmetro Prg.Oper no bloco de configuração. Obs: Para alterar o tempo é necessário desligar o programa em andamento (Sit.Prog = Deslig.) ajustar o tempo desejado e religar (Sit.Prog = Ligado).	00:01 a 99:59 min.
	Status do Programa Atual	Indica e altera o estado do programa atual. Disponível se habilitado no parâmetro Prg.Oper no bloco de configuração. Deslig. O programa definido em N.Pg. é desligado e o controle é feito com o valor de SPn.Prg. Ligado: Inicia o Programa definido em N.Pg. no segmento e no tempo indicados nos parâmetros acima.	
	Set-Point do Alarme	Ajusta o set-point do alarme. Disponível se habilitado no parâmetro Oper.Alm no bloco de configuração.	De Esc. Min. a Esc. Max.

// PROGRAMAS

DISPLAY	NOME	DESCRIÇÃO	VALORES VÁLIDOS
	Bloco de Programas	Indica que o usuário está no bloco de Programas.	
	Número do Programa	Indica o nº do programa editado, ou seleciona um novo programa para edição.	De 01 até 32
	Nº de segmento do Programa	Indica o número de segmentos alocados ao programa.	De 01 até 63
	Apagar ou Corrigir o Programa	Usado para apagar ou corrigir um programa já editado.	Apagar: apaga o programa selecionado Editar: altera os parâmetros do programa selecionado
	Início do Programa	Define se o programa será iniciado ao ligar o controlador.	Auto: executa o programa sempre que liga o controlador. Manual: aguarda o comando Ligado do parâmetro. Sit. Prog para executar o programa.
	Modo de Operação	Ajusta o modo de trabalho para o programa.	0: Desliga controle 1: SP do último segmento 2: Repete automaticamente o programa.
	Set-Point Inicial	Ajusta o ponto de partida para o programa.	De Esc Min. a Esc. Min. definido no bloco de conf.
	Tempo do Segmento	Ajusta o tempo de cada segmento.	De 00:01 a 99:59 min.
	Próximo Set-Point	Ajusta o ponto inicial do segmento. (Que é o início do próximo segmento)	De Esc Min. a Esc. Min. definido no bloco de conf.
	Prioridade	Define por segmento, qual a prioridade seguida; tempo ou temperatura. Se temperat. , o controlador paralisa o set-point e a contagem de tempo sempre que ultrapassar a banda de tolerância Desv.Max do segmento. Se tempo, o controlador cumprirá o tempo previsto para o segmento, independente da temperatura.	Tempo ou Temperat

	Banda de Tolerância	Define o desvio máximo tolerável entre a tempera tura e o set-point durante a execução do segmento. Disponível se no parâmetro anterior a prioridade for temperat.	De 1 a 100° C
	Alarme do Segmento	Define se o alarme será acionado no segmento. Válido se o parâmetro Alarme selecionado para Programa, no bloco de configuração.	Desliga-Nenhum relé atua neste segmento. Alarme-o relé atua neste segmento.
	Acionamento do Alarme	Define em que ponto do segmento o alarme selecionado acionará. Disponível se Al.Segm. selecionado para Alarme .	Fim Segm./Inic Segm
	Final do Programa	Ao término da edição do programa, o display indicará Fim Prg.	Fim Segm./Inic Segm

O programa permite a elaboração de um perfil térmico para o controle automático de um processo. É possível memorizar até 32 programas com número variável de segmentos, num total de 63 segmentos, e a cada segmento definir: tempos, temperaturas, prioridades (tempo ou temperatura), tolerâncias de desvio no caso de temperatura, o alarme e suas atuações. Pode-se assim criar rampas e patamares, em que o SP de acordo com os tempos programados é automaticamente alterado pelo controlador, sem a intervenção do operador.

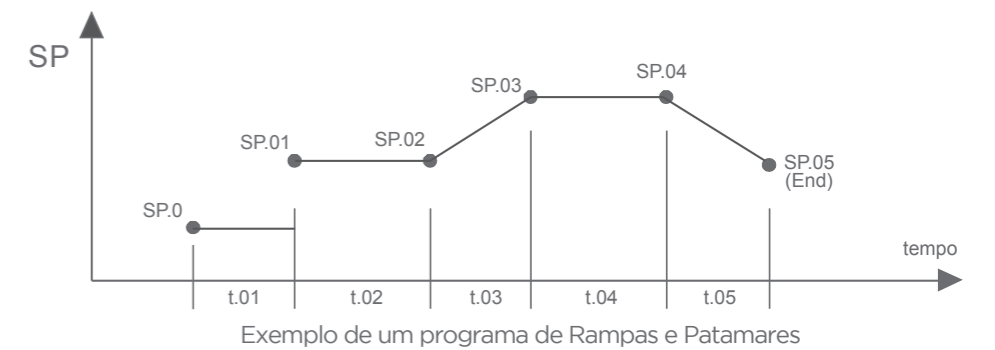

Para editar um programa

1º) Traçar o perfil do programa desejado como o exemplo;

2º) Se necessário, utilizar saídas de alarme/relé no programa, configurar **ALARME** para **Programa** no bloco de configuração;

3º) Habilitar o bloco de programas no parâmetro **Prg.Oper** no bloco de configuração;

4º) Seguir a sequência de configuração do bloco de programas.

Para apagar um programa

1º) Selecionar o programa desejado no bloco de programas;

2º) Selecionar **“Deletar”** no parâmetro **Alt.Prog.**

Para executar um programa editado

1º) Selecionar o programa desejado no bloco de operação **Num. Prg;**

2º) Iniciar o programa alterando o parâmetro **Sit.Prog.** de **“Deslig.”** para **“Ligado”**.

Para avançar ou retroceder um programa

1º) Se o programa estiver sendo executado, desligá-lo no parâmetro **Sit.Prog=“Deslig.”;**

2º) Selecionar o segmento desejado no parâmetro **Sg.At.;**

3º) Ajustar o tempo a ser executado dentro do segmento acima selecionado **Tm 00:00;**

4º) Iniciar o programa alterando o parâmetro **Sit.Prog** de **“Deslig.”** para **“Ligado”**.

Observações:

Confirmar se a entrada, o controle, a escala e os alarmes estão configurados de acordo com o programa selecionado.

Ao iniciar o programa, o controlador primeiro aguarda o processo atingir o set-point inicial **SP 0 Prg.** Para paralisar o programa, alterar o parâmetro **Sit.Prog.** de **“Deslig.”** e para prosseguir do ponto que parou, alterar para **“Ligado”**.

Para desligar o programa, alterar o parâmetro **Sit.Prog.** de **“Deslig.”**. O controle passará a obedecer o **SP**. Na sequência da configuração de um programa, ao chegar no parâmetro **Pt.ACAO** o controlador retornar para **TnPrg(+1)** repetidamente, até que o último segmento seja configurado, indicando ao final **FimPrg.**

Quando alterado um parâmetro, é necessário avançar até o final do segmento para que a alteração seja gravada.

Quando um programa está sendo executado (Ligado), o controlador não permite alterar os parâmetros: **SP n Prg, Entrada, Pto. Dec., Esc. Min., Esc. Max., Alarme, Sg. At, Tm 00:00.**